

# SCHEMA TECNICA

*Base da interni*

Elephant



CE

*Dispositivo medico registrato presso il Ministero della Salute della Repubblica Italiana  
Rep.No.1894015 - CND Y180939 – UDI-DI di Base 805050779002AF*

La **Base da interni** modello **Elephant**, fornita dalla Ditta **Biemme Group S.r.l.** di Reggio Emilia o da fornitore autorizzato è stata progettata **per supportare un sistema posturale** del tipo prescritto dal medico curante all'utente.

Di seguito le caratteristiche del dispositivo medico:

**Fig. 1 Tavola del dispositivo medico**

		um	ESSENZIALE	STD
Età ricoperta		anni	2	10
Altezza utente massima		cm	80	140
Peso massimo Utente		kg	40	40
Peso Base		kg	12	13
Pistone alzata		N	600-800	
D	Ingombro laterale minimo	mm	700	770
E	Ingombro frontale minimo	mm	630	650
F	Variazione in altezza castello	cm	26 ÷ 63	26 ÷ 63
G	Bascula	°	40	40

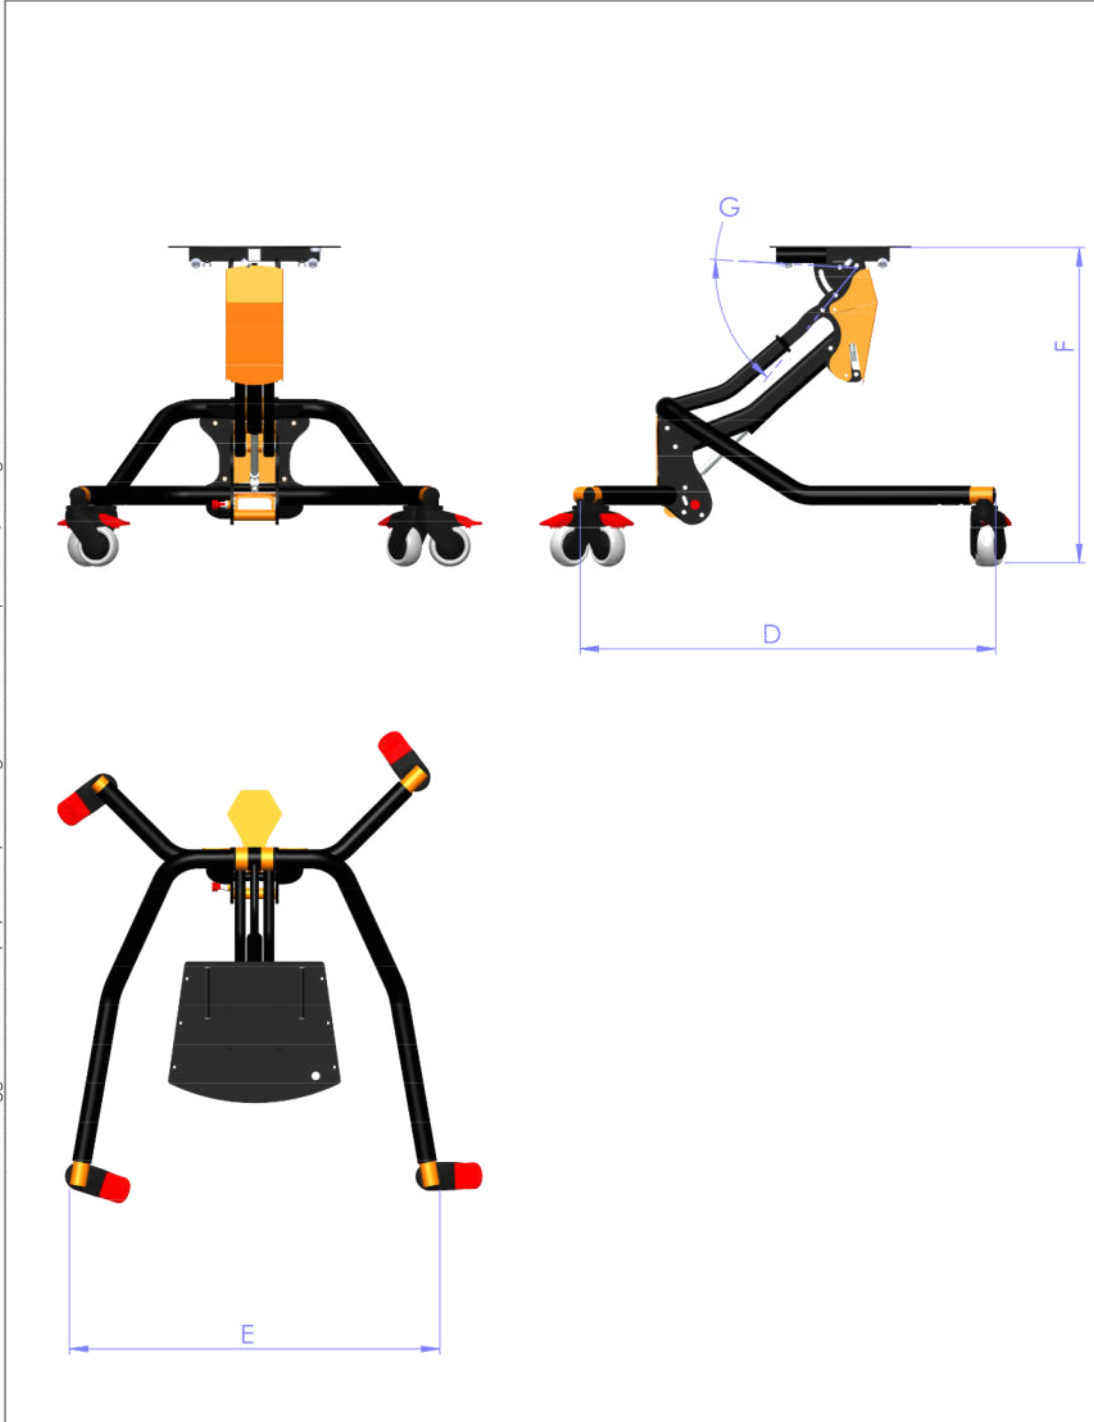
**Fig. 2 Tavola del dispositivo medico provvisto di accessori\***

		um	SMALL	STANDARD
I	Altezza schienale	cm	10 ÷ 30	10 ÷ 30
J	Profondità schienale-pedane	cm	24 ÷ 35	24 ÷ 35
K	Altezza braccioli	cm	10 ÷ 34	10 ÷ 34
L	Distanza braccioli	cm	28 ÷ 44	28 ÷ 44
M	Inclinazione braccioli	°	80	80
N	Adduzione-Abduzione pedane	°	90	90
O	Flesso-estensione pedane	°	40	40
P	Prono-supinazione pedane	°	25	25
Q	Divaricazione pedane	cm	13 ÷ 32	13 ÷ 32
R	Altezza pedane	cm	-4 ÷ -35	-4 ÷ -35
S	Inclinazione sistema pedane	°	60	60
T	Larghezza supporto ventilatore	cm	30	30
U	Lunghezza supporto ventilatore	cm	24	24
V	Larghezza tavolino	cm	46	46
W	Lunghezza tavolino	cm	32	32



\*Tutte misure riferite al castello della base

IL PEZZO DEVE RISULTARE PULITO, SENZA TRUCIOLI, BAVE E AMMACCATURE

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con il divieto di riprodurlo e/o divulgarlo a terzi senza il nostro consenso scritto



This page must not be duplicated or distributed to any third person without our written approval. We will reserve all rights exclusively for our intellectual properties

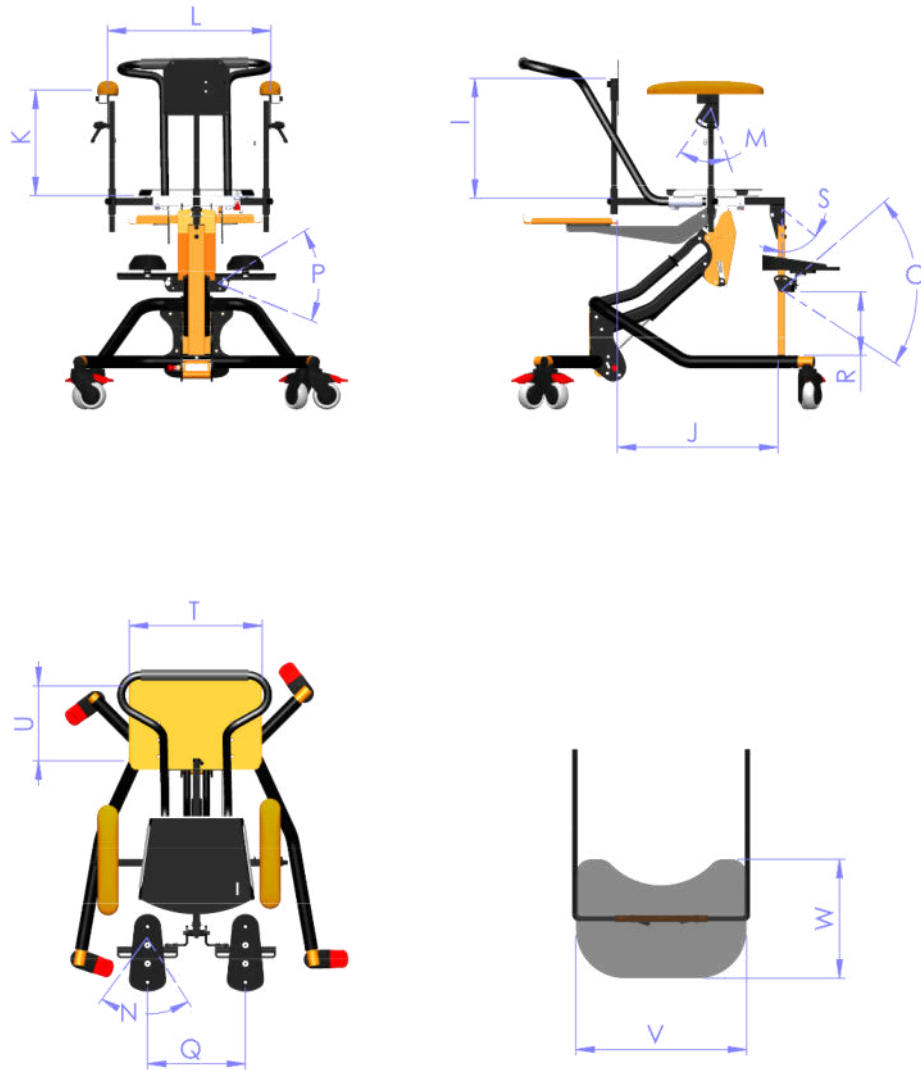
<small>QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA</small> <b>ISO 2768 FH</b> <small>RACCORDI NON QUOTATI: 1mm</small> <small>SMUSSI NON QUOTATI: 0.5 mm x 45°</small>	MATERIALE	MASSA 12.82 kg	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	 SCALA 1:10	FOGLIO 2 DI 2
 <small>officina dell'autonomia</small>	CODICE: ELEPHANT 2		DISEGNATO DA IL		
	DESCRIZIONE:		APPROVATO DA IL		

A4



Fig. 1 Tavola del dispositivo medico

IL PEZZO DEVE RISULTARE PULITO, SENZA TRUCIOLI, BAVE E AMMACCATURE

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con il divieto di riprodurlo e/o divulgarlo a terzi senza il nostro consenso scritto



This page must not be duplicated or distributed to any third person without our written approval. We will reserve all rights exclusively for our intellectual properties

<small>QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA</small> <b>ISO 2768 fH</b> <small>RACCORDI NON QUOTATI: 1mm</small> <small>SMUSI NON QUOTATI: 0.5 mm x 45°</small>	MATERIALE	MASSA 20.49 kg	TRATTAMENTO SUPERFICIALE	 SCALA 1:15	FOGLIO 1 DI 1
	CODICE: ELEPHANT 2		DISEGNATO DA IL		
	DESCRIZIONE:		APPROVATO DA IL		

A4

Fig.2 Tavola del dispositivo medico provvisto di accessori